ENTDECKEN SIE, WIE DIE FREESTYLE LIBRE MESSSYSTEME IHREN PATIENTEN MIT DIABETES DEN ALLTAG ERLEICHTERN KÖNNEN.

Moderne Diabetes-therapie mit FreeStyle Libre 2

20. November 2020

FreeStyle

Abbott

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

FreeStyle Libre 2 Produkteinführung

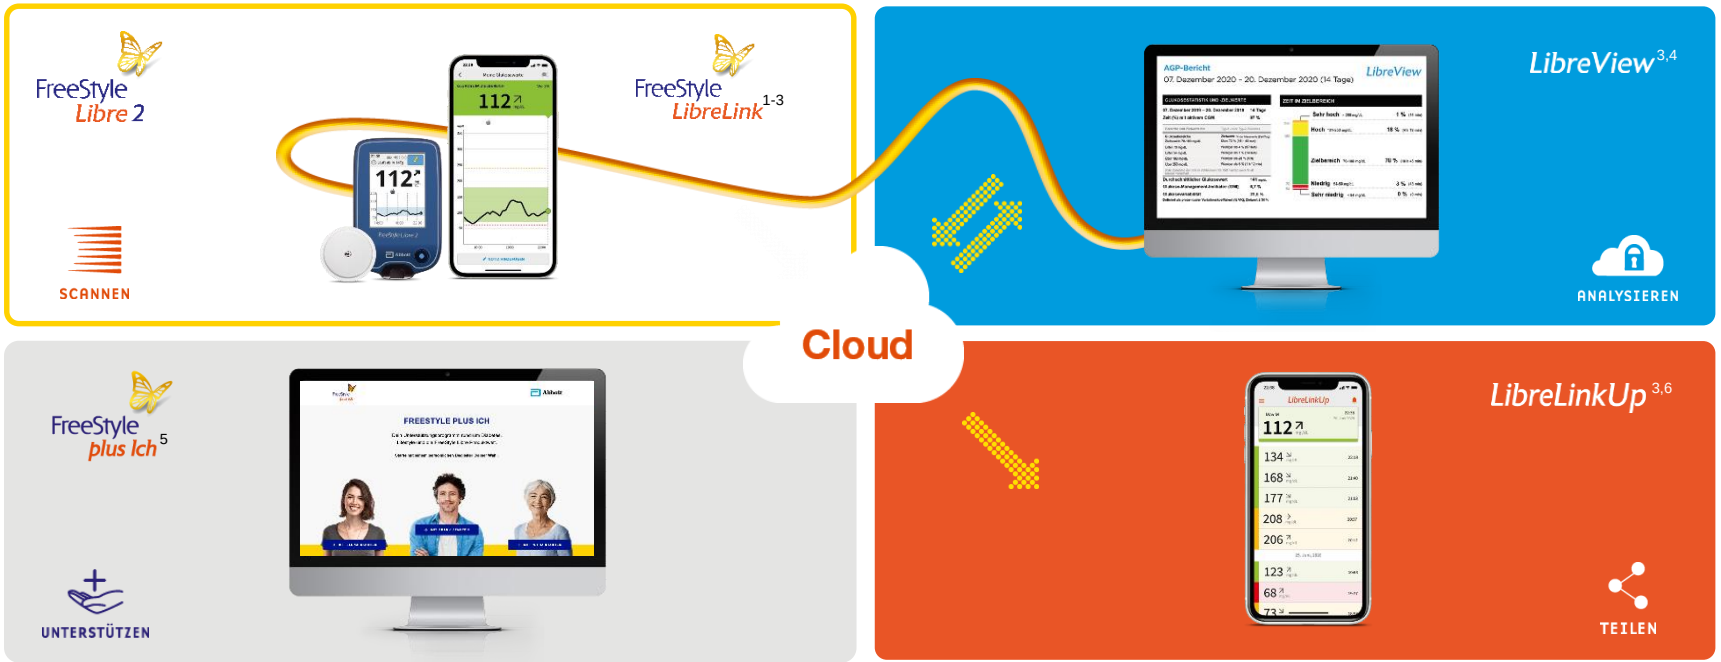

1. Die Nutzung von FreeStyle LibreLink erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. **2.** Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. **3.** Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung. **4.** LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. **5.** FreeStyle plus Ich ersetzt nicht die therapeutische Beratung durch das Diabetesteam. **6.** LibreLinkUp ist eine mobile Applikation, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

Glukose messen mit dem FreeStyle Libre 2 Lesegerät

Agenturfoto. Mit Model gestellt.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

Das FreeStyle Libre 2 Lesegerät kann fast alles, was die FreeStyle LibreLink App[1,2] kann.

1 **AKTUELLER GLUKOSEWERT**
in mg/dL oder mmol/L.

2 **TRENDPFEIL**
zeigt an, wie sich der Glukosewert in naher Zukunft verändert.

3 **GLUKOSEVERLAUF**
der letzten 8 Stunden.

4 **NOTIZFUNKTION**
Mahlzeiten, Insulinanwendung, Sport und andere Ereignisse verfolgen.

5 **TESTSTREIFENÖFFNUNG**
Blutglukose und Ketone messen.

Das Lesegerät ist klein und leicht.

Ergebnisse dank Beleuchtung und farbigem Touchscreen im Dunkeln sehen.

Kann Zuckerwerte von bis zu 90 Tagen speichern.

Optionale Alarme für noch mehr Sicherheit.[3-5]

Glukosedaten manuell in LibreView[6] laden.

1. Die Nutzung von FreeStyle LibreLink erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. **2.** Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. **3.** Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. **4.** Buckingham, B. Journal of Diabetes Science and Technology. 2008; 2(2): 300-306. **5.** Pickup, John C., et al. Diabetes Care. 2015; 38: 544-550. **6.** LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

Eigenschaften und Funktionalitäten

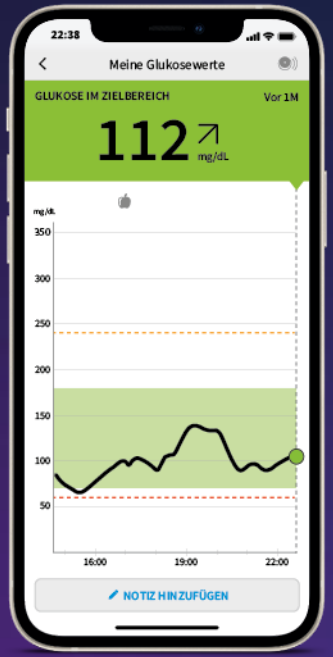

FreeStyle LibreLink

Agenturfoto. Mit Model gestellt.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

Vorteile eines kontinuierlichen Glukosemesssystems für Menschen mit Diabetes

Einfach[1,2] – Die Applikation des Sensors und die Anwendung des Messsystems sind intuitiv.

Schmerzfrei[3,4] – Ersatz für routinehaftes Blutglukosemessen mit einem unangenehmen Stich in den Finger.[5,6]

Mehr Einsicht – Häufigere Messungen im Alltag (ø 12 Scans/Tag)[7,8] und Sicherheit durch Alarme[9-11].

Mehr Lebensqualität – Führt zu gesteigerter Therapiezufriedenheit, höherer Flexibilität und mehr Freiheit.[12,13]

Mehr Sicherheit[10,11] – Optionale Glukose-Alarme[14] schützen Ihre Patienten vor (nächtlichen) Hypoglykämien[7].

Glukosewerte teilen – Mit der LibreLinkUp App[15] haben Angehörige die Möglichkeit, die Glukosewerte und Alarme Ihrer Patienten mitzuverfolgen[16,17].

1. 88% der Teilnehmer einer Erstanwenderstudie stimmten der Aussage zu, dass das Anbringen des Sensors einfach ist. Daten liegen Abbott Diabetes Care vor. **2.** 95% der Teilnehmer einer Erstanwenderstudie stimmten der Aussage zu, dass das Abrufen der Messwerte durch Scannen des Sensors einfach ist. Daten liegen Abbott Diabetes Care vor. **3.** 97% der Teilnehmer einer Erstanwenderstudie stimmten der Aussage zu, dass das Scannen des Sensors schmerzfrei ist. Daten liegen Abbott Diabetes Care vor. **4.** 85% der Teilnehmer einer Erstanwenderstudie stimmten der Aussage zu, dass das Setzen des Sensors schmerzfrei ist. Daten liegen Abbott Diabetes Care vor. **5.** Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfilaments unter die Haut. Der Sensor kann bis zu 14 Tage lang getragen werden. **6.** Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den Messwerten oder den Alarmen des Systems übereinstimmen. **7.** Haak, T., et al. Diabetes Therapy. 2017; 8(1): 55-73. Studie wurde mit 224 Erwachsenen durchgeführt. **8.** Lang, et al. Poster session ATTD19-0299 ATTD Berlin, Germany; 2019. **9.** Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. **10.** Buckingham, B. Journal of Diabetes Science and Technology. 2008; 2(2): 300-306. **11.** Pickup, John C., et al. Diabetes Care. 2015; 38: 544-550. **12.** Yaron, M., et al. Diabetes Care. 2019; 42(7): 1178-1184. **13**. 81% der Teilnehmer einer Erstanwenderstudie gaben an, durch FreeStyle Libre mehr Freiräume gewonnen zu haben. Daten liegen Abbott Diabetes Care vor. **14.** Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. **15.** LibreLinkUp ist eine mobile Applikation, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. **16.** Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung. **17**. Es besteht die Möglichkeit, die LibreLinkUp Einladung anzunehmen und damit Benachrichtigungen und Warnhinweise zu erhalten oder diese abzulehnen. Eine Entscheidung hierüber sollten Sie basierend auf Ihren Kenntnissen und Erfahrungen treffen, bei dem Erhalt eines zu hohen oder zu niedrigen Glukosewerts angemessen reagieren zu können.

Vorteile eines kontinuierlichen Glukosemesssystems für medizinisches Fachpersonal

Grundlage für Therapieentscheidungen – Das Messsystem erzeugt ein vollständiges glykämisches Profil.[1]

Mehr Therapieerfolge – Patienten mit Typ 2 Diabetes können nach 3 Monaten der Anwendung von FreeStyle Libre 2 eine signifikante Reduktion des HbA_{1c}-Wertes um 0,9 % erreichen.[2,3]

Übersichtliche Glukosedaten – Die Daten werden in LibreView[4] geladen und verständlich aufbereitet.[5]

Gemeinsames Therapiemanagement – Patienten erhalten ihre Selbstständigkeit zurück und können sich aktiver an ihrem Diabetesmanagement beteiligen.

1. Für ein vollständiges glykämisches Profil muss der Sensor mindestens einmal alle 8 Stunden gescannt und alle 14 Tage ersetzt werden. **2.** Evans, M., et al. Diabetes Ther. 2019. doi:10.1007/s13300-019-00720-0. **3.** Kröger, J., et al. P 016: Effectiveness of FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System Observed in Real-World, Chart Review Study in Adults with Type 2 Diabetes, DDG, Mai 2019. **4.** LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. **5.** Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung.

FreeStyle LibreLink

Patienten können die FreeStyle LibreLink App[1,2] kostenfrei herunterladen und ihre Werte mit dem Smartphone auslesen.

FreeStyle LibreLink App kostenlos herunterladen

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

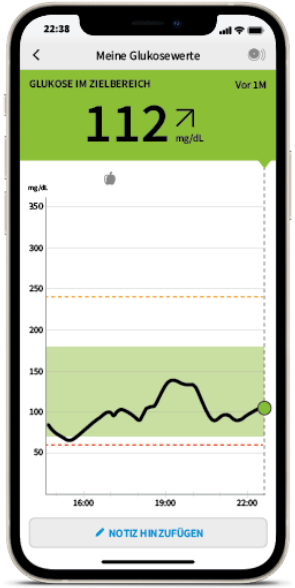

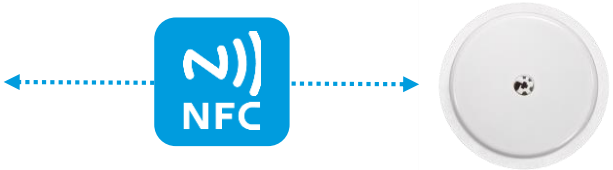

14 Tage

Durch den erweiterten Kopplungszeitraum können Sensoren bis zum letzten Tag der Sensorlaufzeit mit der FreeStyle LibreLink App verbunden werden.

1. Die Nutzung von FreeStyle LibreLink erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. **2.** Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

Trendpfeile richtig interpretieren

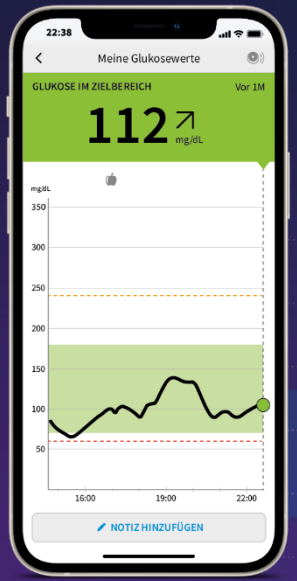

Agenturfoto. Mit Model gestellt

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

Der Trendpfeil zeigt, wo es langgeht.

Glukosewert steigt rasch
d. h. in 15 Minuten steigt er um mehr als 30 mg/dL

Glukosewert steigt
d. h. in 15 Minuten steigt er zwischen 15 und 30 mg/dL

Glukosewert ändert sich langsam
d. h. in 15 Minuten steigt oder fällt er um weniger als 15 mg/dL

Glukosewert fällt
d. h. in 15 Minuten fällt er zwischen 15 und 30 mg/dL

Glukosewert fällt rasch
d. h. in 15 Minuten fällt er um mehr als 30 mg/dL

- Ein stark fallender Trendpfeil kann beispielsweise bei Gabe von schnell wirksamem Insulin auftreten.
- Ein stark fallender Trendpfeil kann während oder nach einer sportlichen Aktivität auftreten.

Bei stabilen Glukosewerten sind die vom FreeStyle Libre Messsystem gemessenen Glukosewerte und Blutglukosewerte sehr ähnlich.

Bei rasch steigenden Glukosewerten können die vom FreeStyle Libre Messsystem gemessenen Glukosewerte **niedriger** liegen als die Blutglukosewerte.

Bei rasch fallenden Glukosewerten können die vom FreeStyle Libre Messsystem gemessenen Glukosewerte **höher** liegen als die Blutglukosewerte.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

LibreLinkUp[1]

LibreLinkUp App
kostenlos herunterladen

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Agenturfoto. Mit Model gestellt.

1. LibreLinkUp ist eine mobile Applikation, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

Patienten können Glukosewerte jetzt noch einfacher teilen

LibreLinkUp

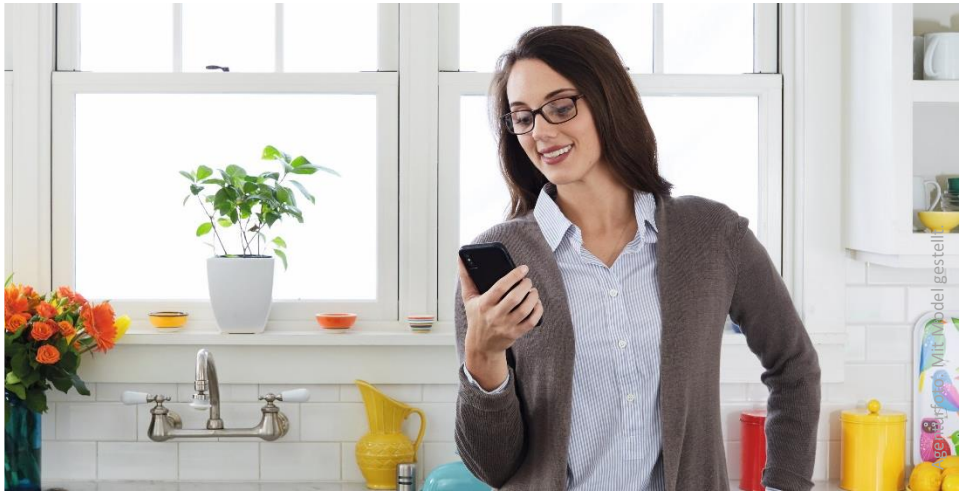

LibreLinkUp[1] ist eine **kostenlose Smartphone-App**, mit der Angehörige die Glukosewerte und Glukose-Alarme[2,3] von Menschen mit Diabetes **per Push-Benachrichtigung auf ihr Smartphone** erhalten können. Solange eine Datenverbindung besteht, können die Werte in Echtzeit geteilt werden.[4,5]

1. LibreLinkUp ist eine mobile Applikation, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. **2.** Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. **3.** Die FreeStyle LibreLink App kann nur Alarme ausgeben, wenn der Sensor nicht zuvor mit dem Lesegerät gestartet wurde. Wenn die FreeStyle LibreLink App und das FreeStyle Libre 2 Lesegerät gleichzeitig verwendet werden sollen, muss der Sensor zuerst mit dem FreeStyle Libre 2 Lesegerät gescannt werden. In diesem Fall kann nur das FreeStyle Libre 2 Lesegerät die Alarme ausgeben. **4.** Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung. **5.** Es besteht die Möglichkeit, die LibreLinkUp Einladung anzunehmen und damit Benachrichtigungen und Warnhinweise zu erhalten oder diese abzulehnen. Eine Entscheidung hierüber sollten Sie basierend auf Ihren Kenntnissen und Erfahrungen treffen, bei dem Erhalt eines zu hohen oder zu niedrigen Glukosewerts angemessen reagieren zu können.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

In 3 Schritten verbinden

LibreLinkUp

Für Patienten

FreeStyle LibreLink

Schritt 1:
FreeStyle LibreLink App[1,2] herunterladen

Schritt 2:
Registrieren

Schritt 3:
Sensor scannen

Familie & Freunde

LibreLinkUp

Schritt 1:
LibreLinkUp App[3] herunterladen

Schritt 2:
Registrieren

Schritt 3: Einladung annehmen[4]

Über die **„Freigabe“**-Funktion der FreeStyle LibreLink App können die ausgewählten Personen eingeladen werden, die Scans zu verfolgen. Die Angehörigen bekommen eine E-Mail mit den Anweisungen, wie sie die LibreLinkUp App installieren können.

Patienten können Personen ihres Vertrauens erlauben, ihre Messergebnisse einzusehen.[4]

Die LibreLinkUp App kann auch Alarme von der FreeStyle LibreLink App empfangen und ausgeben.
1. Die Nutzung von FreeStyle LibreLink erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. **2.** Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. **3.** LibreLinkUp ist eine mobile Applikation, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. **4.** Es besteht die Möglichkeit, die LibreLinkUp Einladung anzunehmen und damit Benachrichtigungen und Warnhinweise zu erhalten oder diese abzulehnen. Eine Entscheidung hierüber sollten Sie basierend auf Ihren Kenntnissen und Erfahrungen treffen, bei dem Erhalt eines zu hohen oder zu niedrigen Glukosewerts angemessen reagieren zu können.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

LibreView [1]

Agenturfoto. Mit Model

1. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

LibreView[1] – Die Lösung, um Glukosedaten auszuwerten

Die Glukosedaten Ihrer Patienten in einem sicheren[2], cloudbasierten Diabetesmanagement-System.

1. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. **2.** Die LibreView Daten werden in ein virtuelles nicht öffentliches Netzwerk übertragen und auf einer SQL-Server-Datenbank gehostet. Die Daten sind auf Dateiebene verschlüsselt. Die Verschlüsselung und Art der Schlüsselspeicherfunktionen verhindern, dass der Cloud-Hosting-Anbieter (Amazon Web Services) die Daten einsehen kann. Bei Nutzung von LibreView in Deutschland werden die Daten auf Servern in der EU gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer-Account ist passwortgeschützt.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

Agenturfoto. Mit Model gestellt.

Vereinfachtes Diabetesmanagement für Sie und Ihre Patienten mit LibreView[1].

Sicher[2] und zuverlässig

Jederzeit und überall[3] Zugriff auf Glukosedaten in einem sicheren, webbasierten Diabetesmanagement-System.

Einfaches Hochladen[3]

Mit dem Smartphone:
Die FreeStyle LibreLink App[4,5] übermittelt die gescannten Glukosewerte bei bestehender Internetverbindung automatisch an LibreView.

Schneller Überblick

Das vollständige glykämische Profil[6] Ihrer Patienten auf einen Blick für fundierte Therapieentscheidungen.

1. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. **2.** Die LibreView Daten werden in ein virtuelles, nicht öffentliches Netzwerk übertragen und auf einer SQL-Server-Datenbank gehostet. Die Daten sind auf Dateiebene verschlüsselt. Die Verschlüsselung und Art der Schlüsselspeicherfunktionen verhindern, dass der Cloud-Hosting-Anbieter (Amazon Web Services) die Daten einsehen kann. Bei Nutzung von LibreView in Deutschland werden die Daten auf Servern in der EU gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer-Account ist passwortgeschützt. **3.** Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung. **4.** Die Nutzung von FreeStyle LibreLink erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. **5.** Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. **6.** Für ein vollständiges glykämisches Profil muss der Sensor mindestens einmal alle 8 Stunden gescannt und alle 14 Tage ersetzt werden.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

Beispielbericht aus LibreView[1]: das Ambulante Glukoseprofil (AGP)

Tagesmuster

Der Bericht „Tagesmuster“ bildet das Ambulante Glukoseprofil (AGP) ab. Das AGP projiziert die über einen Zeitraum von 14 Tagen kontinuierlich gemessenen Glukosewerte in strukturierter Form auf einen „typischen“ 24-Stunden-Standard-Tag.*

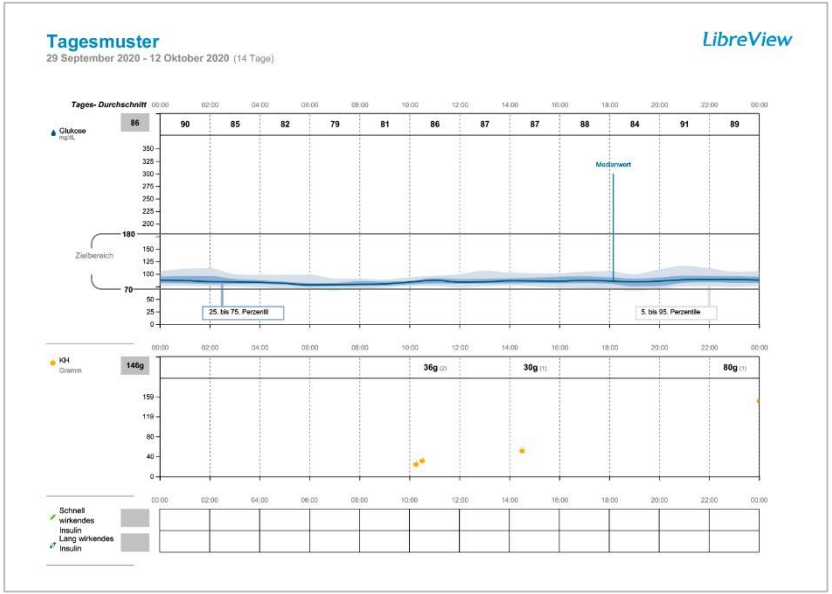

Entdecken Sie viele weitere Berichte unter:
www.LibreView.com

* Das AGP fasst Glukosewerte über den Tag in Perzentilen zusammen (10., 25., 50. (Median), 75. und 90. Perzentil). Ein Perzentil stellt den Bereich dar, unter den eine bestimmte Prozentzahl an Werten fällt, z. B. das 25. bis 75. Perzentil zeigt, wo sich 50 % der gemessenen Werte finden lassen.

1. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

Die Welt von FreeStyle plus Ich[1]

FreeStyle plus Ich

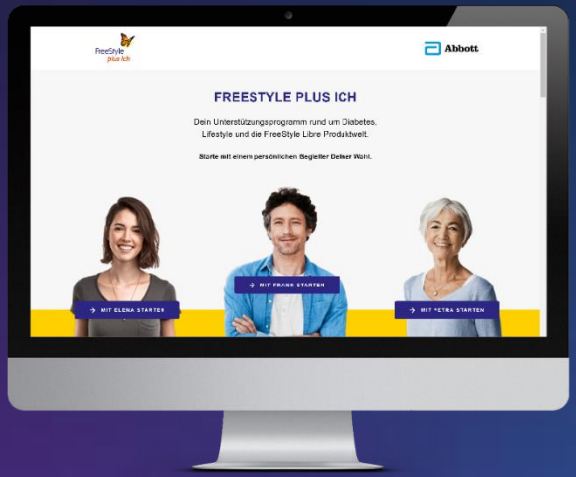

Agenturfoto. Mit Model gestellt.

1. FreeStyle plus Ich ersetzt nicht die therapeutische Beratung durch das Diabetesteam.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

FreeStyle plus Ich[1]: Das exklusive Patientenprogramm

Spannende Themen und Wissenswertes rund um Diabetes[1] und das FreeStyle Libre Messsystem

Kostenlose Webinare und E-Learnings besuchen

Persönliche Begleiter führen durch die Welt von FreeStyle plus Ich

Mitmachen und **exklusive Prämien** sichern

Kostenlos anmelden unter: **www.Mein.FreeStyle.de**

1. FreeStyle plus Ich ersetzt nicht die therapeutische Beratung durch das Diabetesteam.

© 2020 Abbott | ADC-30181 v1.0 | Geschützt und vertraulich – nicht verbreiten

Agenturfoto. Mit Model gestellt.

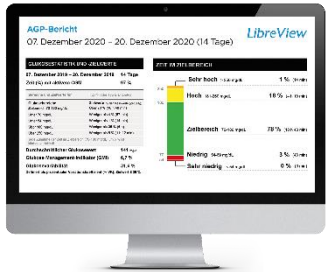

Ernährungsanpassung mit dem neuen „Zucker-Check“

FreeStyle Libre 2

life. to the fullest.

Abbott

Das Lesegerät der FreeStyle Libre Messsysteme ist sowohl in mg/dL als auch mmol/L erhältlich. Die FreeStyle LibreLink App kann beim initialen Setup sowohl auf mg/dL als auch mmol/L eingestellt werden. FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken von Apple Inc., mit Sitz in den USA und weiteren Ländern.

© 2020 Abbott | ADC-29342 v1.0

© 2020 Abbott | ADC-29342 v1.0

Abbildmaterialien

Der neue Zucker-Check

Anschauliche Darstellung und Vergleich von Glukoseverläufen bei Ernährung und Bewegung – einfach für jeden Test und jede Person

Vergleichen Sie jetzt verschiedene Lebensmittel im Zucker-Check unter: www.mein.FreeStyle.de/Zucker-Check

Material für Sie und für Menschen mit Diabetes:

Flyer

Download Material

Print-Material

Abbott